


CAU-3 キャリブレーションユニット

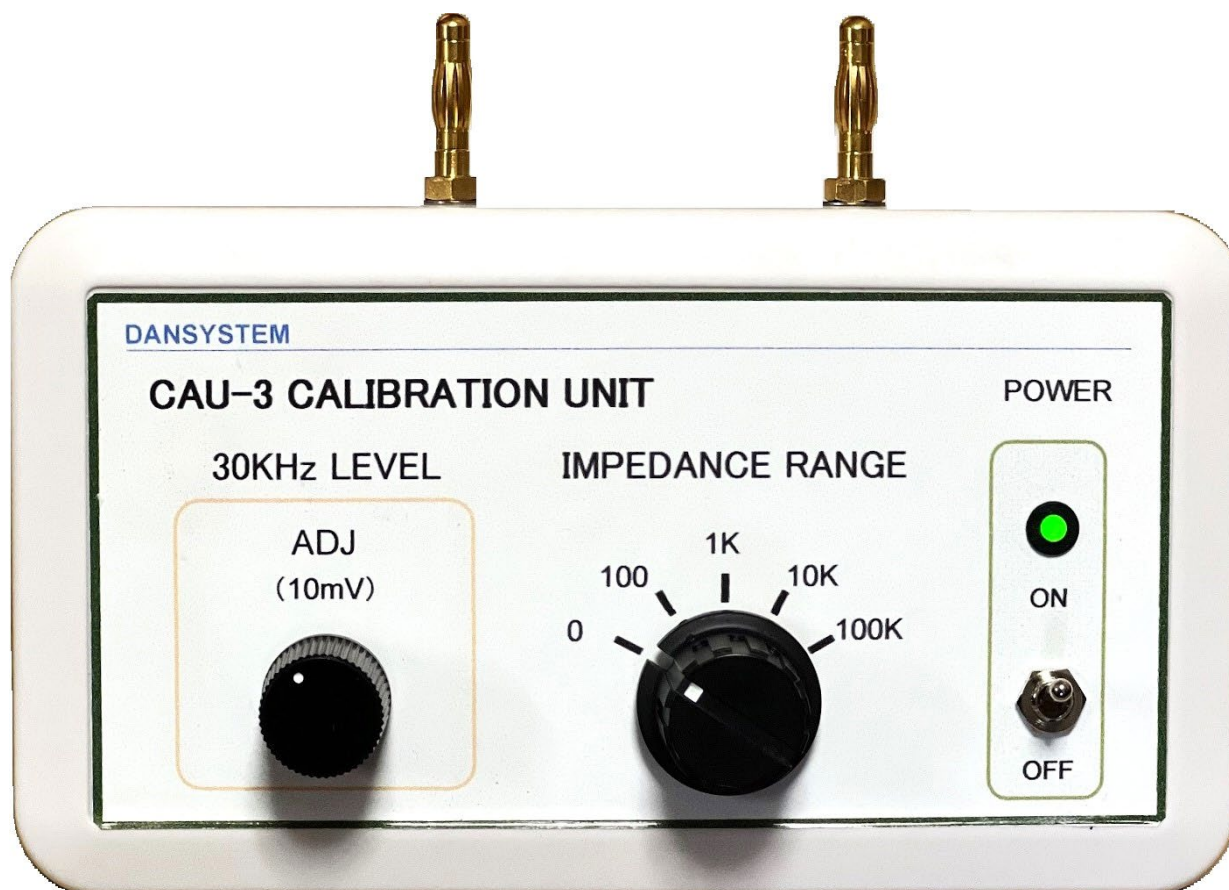

水晶発振器を内蔵した小型30KHz発振器で、CLT-1/CLT-10/CLT-20部品直線性試験装置を校正するために使用します。マルチメーター(周波数も30KHzが測定できるもの)と組み合わせて使用します。

CLT-10/CLT-20 部品直線性試験装置に使用する時は、マニュアルに準拠した校正ができます。9V乾電池(006P)で動作し、測定端子に直接挿入して使用します。

30KHz出力電圧 : 10mV

出力インピーダンス : $50\Omega / 50\Omega + 100\Omega / 50\Omega + 1K\Omega / 50\Omega + 10K\Omega / 50\Omega + 100K\Omega$

135×75×35mm(本体ケースのみ), 300g.